

色谱柱使用说明书(节选)

SUGAR 系列：SC1821

1 色谱柱规格

产品名称	理论塔板数	基 质	分离模式	抗衡离子	排阻限	尺寸 I.D.×L(mm)
SC1821	13, 000 以上	苯乙烯-二乙 烯基苯共聚物	SEC+配位 体交换	磺基 (Ca ⁺)	10,000	8.0×300

产品名称	粒径 (μ m)	最大耐压 (MPa)	常用流量 (mL/min)	最大使用流量 (mL/min)	使用温度 范围 (℃)	出厂时溶剂
SC1821	6	4.0	0.5~1.0	1.5	~95	H ₂ O

标准使用条件：流动相 H₂O；流量 0.5~1.0 mL/min；色谱柱温度 70~80°C

流动相使用范围：H₂O~20%CH₃CN/H₂O；

2 使用上的注意事项

I 色谱柱的安装与取下

(1) 色谱柱的安装与泵的启动

- 1) 泵的流量设为 0.2-0.3mL/min。首先将配管内的气泡排出。
- 2) 送液的同时，将色谱柱安装于装置中，使流动相按照箭头方向流过色谱柱。先连接进口，在确认液体缓缓从出口流出后连接出口。对连接部是否漏液进行确认。
- 3) 在上述的流量下将色谱柱加热到设定温度。
- 4) 达到设定温度后，将流量缓缓升至设定流量。

(2) 分析结束（不需取下色谱柱次日继续分析）

- 1) 将流量降为 0.2-0.3mL/min 送液。
- 2) 关闭恒温槽的加热开关。
- 3) 色谱柱降至室温后再停泵。
- 4) 色谱柱连接在装置的状态下关机。

(3) 分析结束（需要取下色谱柱）

- 1) 将流量降为 0.2-0.3mL/min 送液。
- 2) 关闭恒温槽的加热开关。
- 3) 0.2-0.3mL/min 持续送液至色谱柱降至室温。
- 4) 色谱柱降至室温后再停泵，从装置中取下色谱柱。
- 5) 色谱柱的两端用栓堵上，放在温度恒定的地方保管。

II 操作上的注意事项

- (1) 流动相中添加有机溶剂如乙醇、乙腈等，浓度一定要低于 20%。
- (2) 绝对要避免压力或流量的突然变化。
- (3) 色谱柱温度不适当，会由于端基异构体的分离导致峰形变宽，因此色谱柱要在 70~95°C 的范围内使用。

- (4) 一根色谱柱的最高使用压力是 4MPa。推荐使用带有限制器的满量程为 10MPa 的压力计。
- (5) 最高使用流量是 1.0 mL/min。但是在 40°C 以下使用时是 0.5mL/min。
- (6) 保护柱不仅是除去样品中的污染物来保护分析柱的，对于泵的脉动或压力变化也有一定程度的保护作用。因此尽量使用保护柱。
- ◎如果使用时超过了规定压力、规定流量，致使色谱柱性能降低，这是无法复原的，对此请特别注意。

3 色谱柱性能的测试方法


按照下面的条件，对色谱柱进行性能测试（详情请参考色谱柱附带的出厂检查报告 COA）

色谱柱	流动相	流量	色谱柱温度	样品	注入量
SC1821	H ₂ O	1.0mL/min	80°C	1%Glycerol	5 μ L

理论塔板数的计算公式

$$N=5.54 \left(\frac{Rt}{W} \right)^2$$

N: 理论塔板数、 Rt: 保留时间、 W: 半峰宽

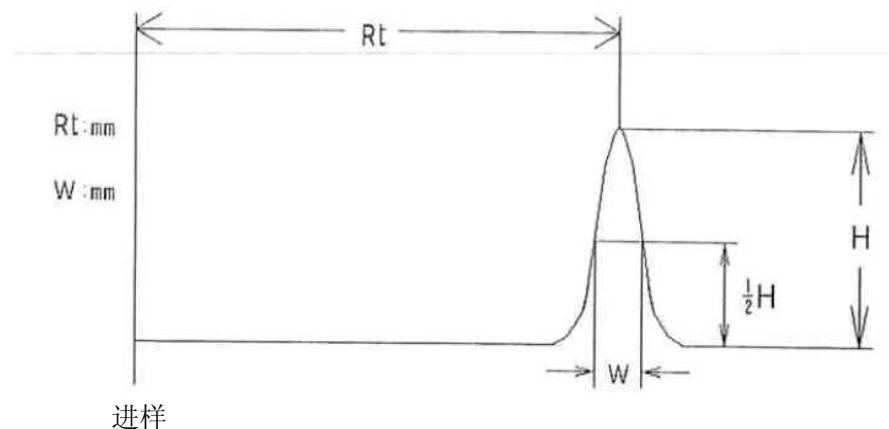

4 色谱柱的再生

SC1821 是对离子型交换树脂，因此会发生试料中的离子吸附、离子交换、对离子改变等现象等。一旦出现这些现象，分离模式就会发生变化。为了纠正、预防发生性能改变，需要按照下面的操作对色谱柱进行再生。

色谱柱	再生液	色谱柱温度	操作
SC1821	0.1M Ca (NO ₃) ₂	50°C	0.5mL/min 送液 50mL